

Certificado de Calibração

Data da Calibração: 25/03/10

Data da Emissão: 26/03/10

n. 1194/10

Página 1 de 2

1. CONTRATANTE: POLIEDRO COM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO LTDA
Rua Dr. Zuquim, 935 - São Paulo - SP

2. SOLICITANTE: O mesmo

3. PADRÃO DE RUGOSIDADE (CALIBRADO):

Nº de Série: Não consta

Nº de Identificação: PE 064

Fabricante: MAHR

Ra: 0,96 μm

Rz: 3,5 μm

4. PADRÃO UTILIZADO:

4.1. Máquina de Medir Rugosidade

Nº Registro (CERTI): RC 2754

U: (0,005+R/57) μm , para Ra

(0,034+R/68) μm , para Rz

Rastreabilidade: Certificado de Calibração CERTI
0005/10, de 11/01/10, válido até 01/12.

4.2. Padrão de Amplificação Vertical

Nº Registro (CERTI): RC 2907

U: 0,025 μm

Rastreabilidade: Certificado de Calibração PTB 002 PTB
09, de 19/01/09, válido até 01/14.

5. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO:

PC-245

Os parâmetros de rugosidade estão definidos segundo norma ISO 4287 e norma ISO 13565-2. Os filtros usados correspondem a norma ISO 3274 e ISO 13565-1.


O padrão foi analisado utilizando um filtro cut-off (Lc) de 0,8 mm, com filtro de onda Gaussiano.

As medições foram executadas utilizando-se um apalpador de 2 μm , uma velocidade de medição de 0,5 mm/s e com uma força de medição de 1,5 mN.

Utilizou-se um comprimento avaliado de 4,8 mm que corresponde a um comprimento de 6 vezes o filtro de onda cut-off, sendo a metade do primeiro e a metade do último cut-off descartados.

5.1 Medição do Perfil de Rugosidade:

O padrão foi medido segundo instrução do PTB 5-AA-5.12-011. O plano de calibração se encontra na figura abaixo.

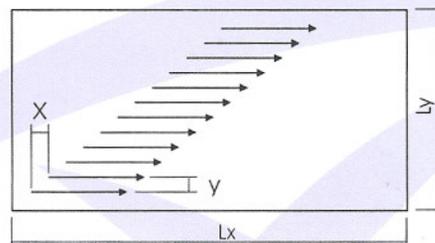

Observações:

Condições Ambientais Durante a Calibração:

- Temperatura: (20,0 \pm 0,3) °C

- Umidade Relativa do Ar: (50 \pm 10) %ur

A incerteza expandida (U) de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (v_{eff}) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02 (1999). Os valores de k e v_{eff} são apresentados na tabela de resultados.

OBS: O padrão apresenta riscos que influenciam nos valores medidos.

Certificado de Calibração

Data da Calibração: 25/03/10

Data da Emissão: 26/03/10

n. 1194/10

Página 2 de 2


A influência do sistema de medição bem como do ambiente ao redor da mesma foram determinadas utilizando-se um plano óptico de excelente qualidade e usando os mesmos parâmetros que foram aplicados ao padrão de rugosidade. Assim o Rz1max é de 0,082 μm .

6. RESULTADOS:

6.1 Medição dos Parâmetros de Rugosidade:

Parâmetro	SMC [μm]	U [%]	k	V_{eff}
Ra	0,969	3	2,01	219
Rz	3,62	8	2,20	14
Rz1max	4,3	26	2,25	11

7. Perfil de Rugosidade (Com filtro):

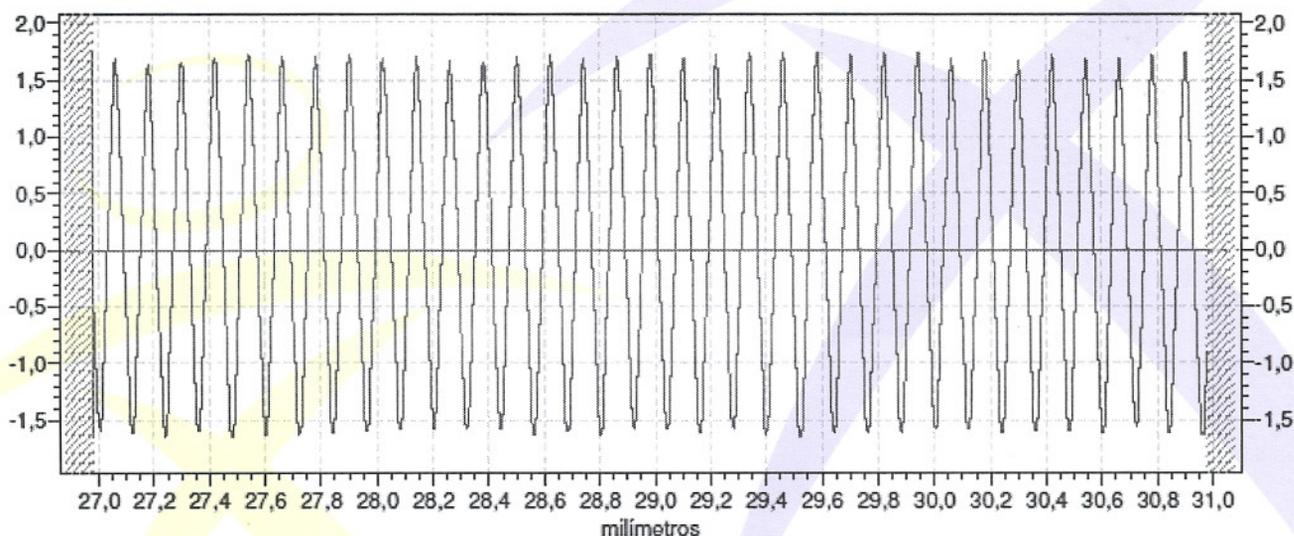

Clodoaldo de Campos Marques
Gerente Técnico

Girlei Fagundes Flores Junior
Técnico Metrologista